Connexion de sondes aux stimulateurs cardiaques et défibrillateurs Boston Scientific

RÉSUMÉ

Cet article résume les étapes à suivre pour connecter correctement des sondes aux stimulateurs cardiaques et défibrillateurs Boston Scientific référencés ci-contre.

Vous trouverez le mode d'emploi complet dans le guide technique des produits respectifs.

Produits Référencés

ADVANTIO™, INGENIO™, VITALIO™, FORMIO™, ALTRUA™ gamme de stimulateurs cardiaques, INVIVE™, INTUA™, INLIVEN™ CRT-Ps, INCEPTA™, PUNCTUA™, ENERGEN™ TELIGEN™, COGNIS™, CONFIENT™, LIVIAN™ ICDs and CRT-Ds

Les produits mentionnés peuvent faire l'objet de marques déposées ou non par Boston Scientific Corporation ou une de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les produits référencés ici peuvent ne pas être autorisés dans toutes les zones géographiques. Pour obtenir des informations détaillées concernant le fonctionnement du dispositif, se reporter aux instructions complètes d'utilisation disponibles sur : www.bostonscientific.com/cardiac-rhythmresources/international-manuals.html.

PRÉCAUTION : Conformément à la loi, ce dispositif ne peut être vendu ou distribué que par un médecin ou sur prescription médicale. Les indications, contre-indications, précautions et mises en garde figurent sur l'étiquette du produit.

Schémas créés par Boston Scientific Corporation, sauf indication contraire.

CRT-D: Defibrillatore con terapia di resincronizzazione cardiaca
CRT-P: Pacemaker con terapia di resincronizzazione cardiaca
ICD: Defibrillatore cardioverter impiantabile
S-ICD: Défibrillateur implantable sous-cutané

Contacts

Amériques
(Caribbean et Amérique centrale, Amérique du Nord et du Sud)
www.bostonscientific.com

Services Techniques
Service Client LATITUDE 1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

Services Patients
1.866.484.3268

Europe, Moyen Orient, Afrique
Services Techniques
+32 2 416 7222
eurtechservice@bsci.com

Support Médecin LATITUDE
latitude.europe@bsci.com

Asie-Pacifique
Services Techniques
+61 2 8063 8299
aptechservice@bsci.com
japantechservice@bsci.com

Service Client LATITUDE
latitude.asiapacific@bsci.com
japan.latitude@bsci.com (Japon)

© 2013 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All Rights Reserved.

Étapes à suivre

Examiner le port de sonde pour vérifier sa liberté, la vis doit être en position complètement desserrée et donc invisible.

Insérer précautionneusement la clé à couple à travers la dépression du bouchon, visible en son centre. Cette manœuvre va ouvrir le bouchon et permettre au gaz ou au fluide présent de s'échapper du port de sonde.

Insérer la sonde et vérifier que l'extrémité de la broche dépasse visiblement du connecteur.

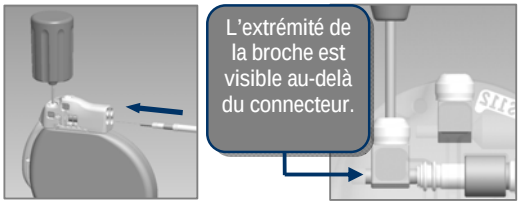

S'assurer que la clé est positionnée perpendiculairement (90°) au bloc connecteur. Tout en maintenant une pression sur la sonde, serrer la vis en tournant la clé dans le sens horaire jusqu'à entendre un seul clic.

NOTE : il n'est pas nécessaire de continuer à exercer une force de serrage au-delà de celle exercée par la clé à couple.

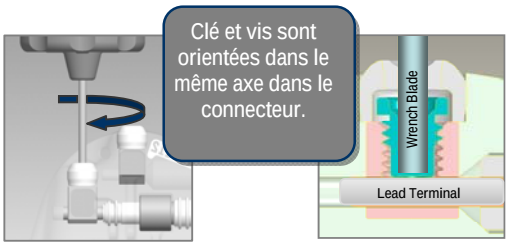

Retirer la clé à couple en la tirant droit dans l'axe

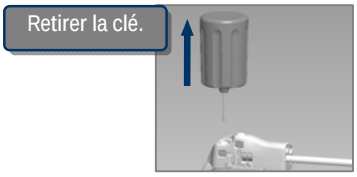

Vérifier la qualité de la connexion en exerçant une simple traction sur *chaque broche* de sonde. Ne pas tirer sur le corps de sonde ou sur plus d'une broche à chaque fois. Si une broche n'est pas fixée, réinsérer la clé à couple, desserrer la vis dans le sens anti-horaire puis répéter les étapes ci-dessus.